

AUDIOGRAMA ADMISSIONAL (SEQUENCIAL)

Funcionário: Joao Vitor Viana Correia (M) (13/11/00) (25 anos)



Cargo: Ajudante de Motorista I

Empregador: Casas da Água Materiais para Construção Ltda (Casas da Água)

CPF: 118.365.339-50

RG:

CNPJ: 13.501.187/0027-98

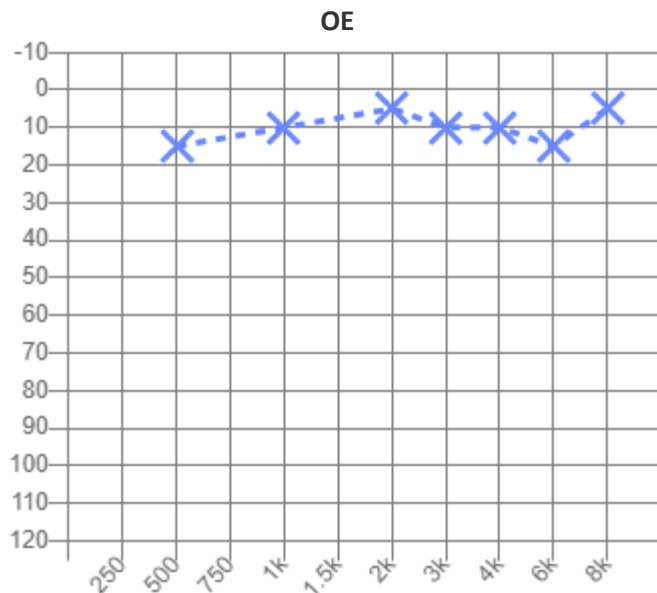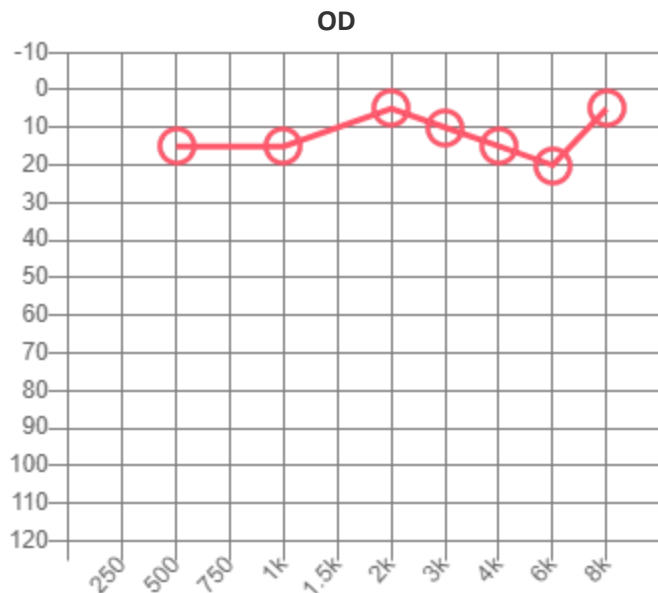

LIMIAR OD

	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA		15	15	5	10	15	20	5	dB
VO									dB

LIMIAR OE

	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA		15	10	5	10	10	15	5	dB
VO									dB

IRF

	MONOS	DISSIL
OD		
OE		

RINNE

	500	1k	2k	4k
OD				
OE				

WEBBER

	250	500	1k	2k	4k	
OD						OE

Audiômetro: AO - 300 (calibração: 22/06/2026)

R.A.: Sim, 14 hora(s)

Diagnóstico: OD: Normal OE: Normal

Meatoscopia: OD: Normal OE: Normal

Conclusão: OD/OE - Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

☒ Normal ☐ Estável ☐ Alterado ☐ Agravamento

DATA: 23/07/2026

Franco A. F. Soares
Fonoaudiólogo
CRF 3-2105-9

Assinatura do emitente



Joao Vitor Viana Correia
CPF: 118.365.339-50