

AUDIOGRAMA ADMISSIONAL (INICIAL)

Funcionário: Paulo Cesar Schneider (M) (03/05/82) (44 anos)

CPF: 038.397.139-00

Cargo: Motorista**


Empregador: Casas Da Agua Materiais Para Construção Ltda (Casas Da Agua")

CNPJ: 13.501.187/0007-44


Emitente: *Gabriela Freitas Damasco

CRFa: 9185 - SC

OD

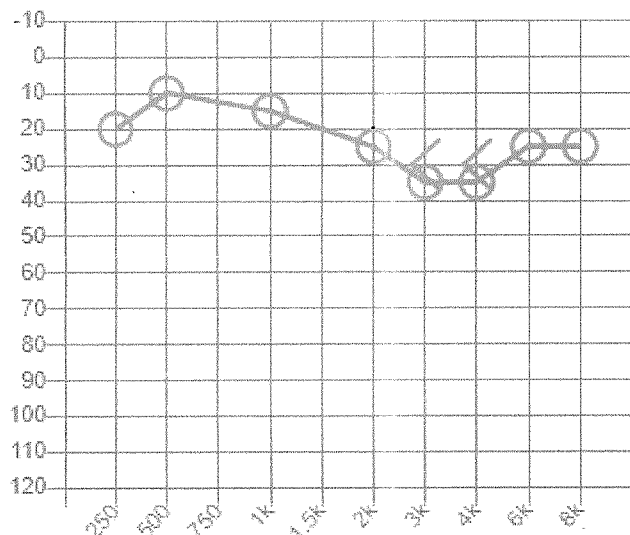

OE

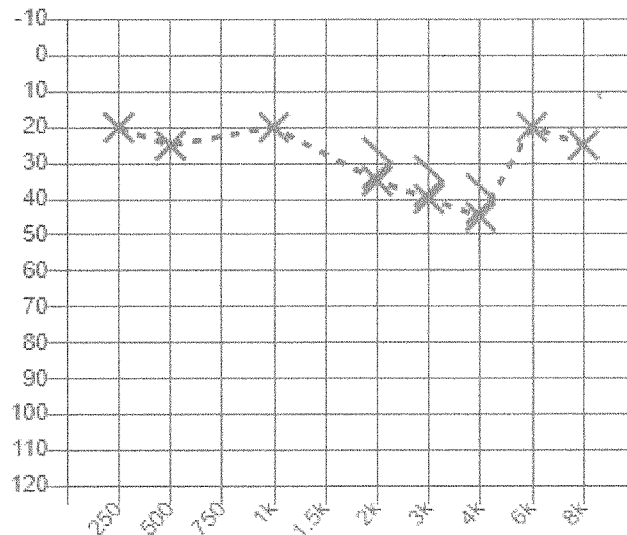

LIMIAIR OD

	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA	20	10	15	25	35	35	25	25	dB
VO					30	30			dB

LIMIAIR OE

	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA	20	25	20	35	40	45	20	25	dB
VO				30	35	40			dB

IRF

	MONOS	DISSIL
OD		
OE		

RINNE

	500	1k	2k	4k
OD				
OE				

WEBBER

	250	500	1k	2k	4k	
OD						OE

Audiômetro: AMPLIVOX 260 (calibração: 24/02/2026)

R.A.: Sim, 14 hora(s)

Diagnóstico: OD: Alterado OE: Alterado

Meatoscopia: OD: Normal OE: Normal

Observação: Sugere-se protetor auditivo tamanho G.

Conclusão:
OD Perda auditiva do tipo neurosensorial
OE Perda auditiva do tipo neurosensorial
De acordo com o Anexo I da NR7

☐ Normal ☐ Estável ☒ Alterado ☐ Agravamento

DATA: 19/05/2026

Gabriela Damasco
Fonoaudióloga
CRFa 9185

***Gabriela Freitas Damasco**
CRFa: 9185 / SC

Paulo C. Schneider

Paulo Cesar Schneider
CPF: 038.397.139-00