
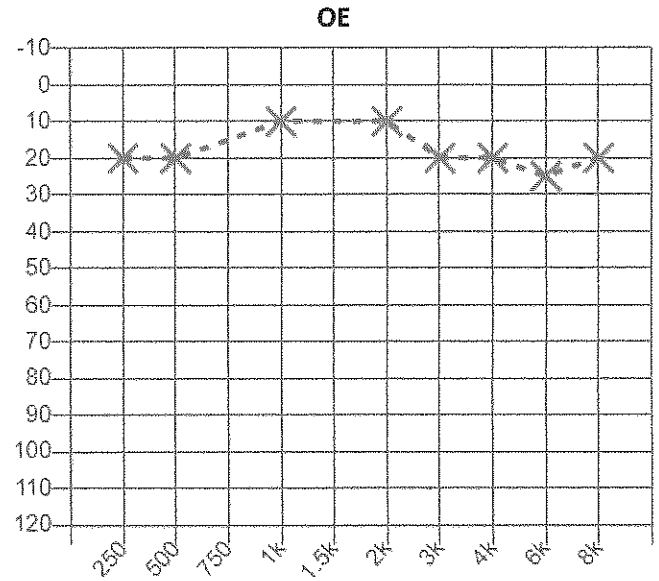


AUDIOGRAMA ADMISSIONAL (INICIAL)

Funcionário: Pedro Henrique Hackenhar Kraus (M) (23/09/04) (21 anos) **CPF:** 139.630.489-48
Cargo: Ajudante de Motorista*
Empregador: Casas Da Agua Materiais Para Construcao Ltda (Casas Da Agua") **CNPJ:** 13.501.187/0007-44
Emitente: * Cíntia Kovalski (Fonoaudióloga) **CRFa:** 8151/7 - SC

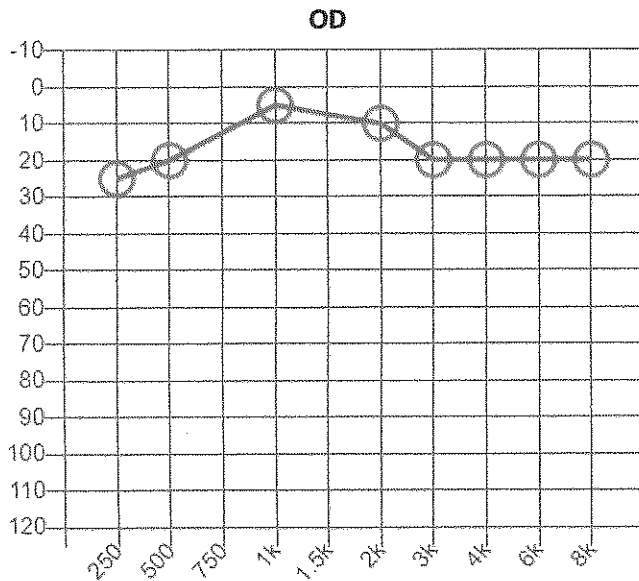

LIMIAR OD									
	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA	25	20	5	10	20	20	20	20	dB
VO									dB

LIMIAR OE									
	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA	20	20	10	10	20	20	25	20	dB
VO									dB

IRF		
	MONOS	DISSIL
OD		
OE		

RINNE				
	500	1k	2k	4k
OD				
OE				

WEBBER					
	250	500	1k	2k	4k
OD					
OE					

Audiômetro:	AMPLIVOX 260 (calibração: 24/02/2026)	R.A.:	Sim, 14 hora(s)
Diagnóstico:	OD: Normal OE: Normal	Meatoscopia:	OD: Normal OE: Normal
Observação:	Conduto Auditivo: Tamanho M		
Conclusão:	Limiares auditivos dentro dos limites aceitáveis bilateralmente De acordo com o Anexo I da NR7		

☒ Normal ☐ Estável ☐ Alterado ☐ Agravamento

DATA: 05/08/2026

CINTIA DIAS KOVALSKI
VIANA:81029209049

Assinado de forma digital
por CINTIA DIAS KOVALSKI
VIANA:81029209049
Dados: 2026.08.05 14:16:00
-03'00'

* Cíntia Kovalski (Fonoaudióloga)
CRFa: 8151/7 / SC

Pedro Henrique Hackenhar Kraus
CPF: 139.630.489-48