
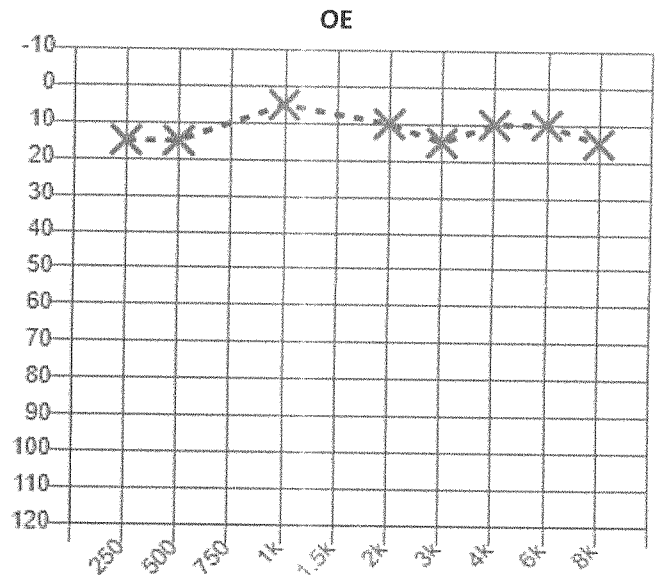


AUDIOGRAMA ADMISSIONAL (INICIAL)

Funcionário: Matheus dos Santos Ropke (M) (19/09/97) (28 anos) **CPF:** 112.004.599-11
Cargo: Ajudante de Motorista*
Empregador: Casas Da Agua Materiais Para Construção Ltda (Casas Da Agua") **CNPJ:** 13.501.187/0007-44
Emitente: * Cíntia Kovalski (Fonoaudióloga) **CRFa:** 8151/7 - SC

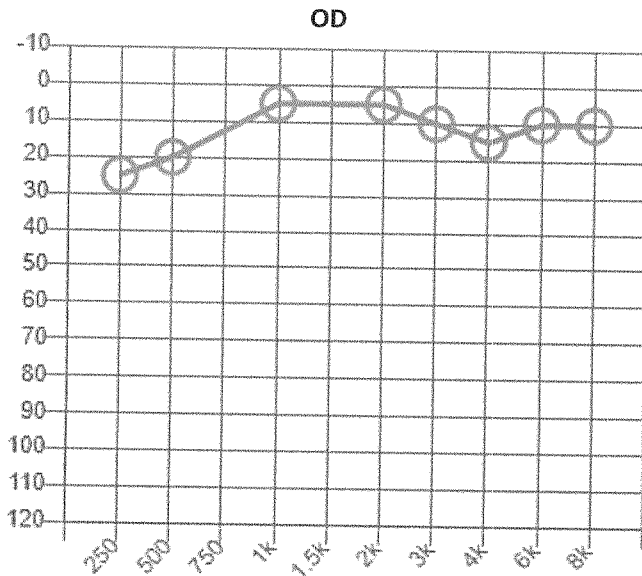

LIMIAR OD									
	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA	25	20	5	5	10	15	10	10	dB
VO									dB

LIMIAR OE									
	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA	15	15	5	10	15	10	10	15	dB
VO									dB

IRF		
	MONOS	DISSIL
OD		
OE		

RINNE				
	500	1k	2k	4k
OD				
OE				

WEBBER					
	250	500	1k	2k	4k
OD					
OE					

Audiômetro:	AMPLIVOX 260 (calibração: 24/02/2026)	R.A.:	Sim, 14 hora(s)
Diagnóstico:	OD: Normal OE: Normal	Meatoscopia:	OD: Normal OE: Normal
Observação:	Sugere-se protetor auditivo tamanho M		
Conclusão:	Limiares auditivos dentro dos limites da normalidade bilateralmente De acordo com o Anexo I da NR7		

☒ Normal ☐ Estável ☐ Alterado ☐ Agravamento **DATA:** 25/03/2026

CINTIA DIAS
KOVALSKI

VIANA:81029209049

* Cíntia Kovalski (Fonoaudióloga)

CRFa: 8151/7 / SC

Assinado de forma digital
por CINTIA DIAS KOVALSKI
VIANA:81029209049
Dados: 2026.03.25 09:44:16
-03'00'

matheus dos Santos Ropke
Matheus dos Santos Ropke
CPF: 112.004.599-11