
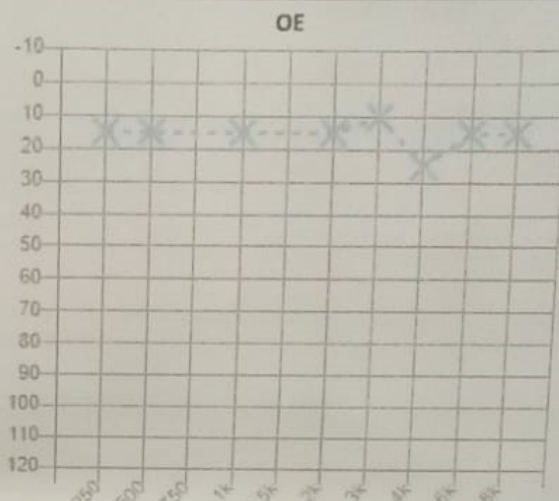


AUDIOGRAMA ADMISSIONAL (SEQUENCIAL)

Funcionário: Kelvin Manuel Romero Azocar (M) (02/11/90) (35 anos) **CPF:** 713.068.372-43
Cargo: Ajudante de Motorista*
Empregador: Casas Da Agua Materiais Para Construcao Ltda (Casas Da Agua") **CNPJ:** 13.501.187/0007-44
Emitente: *Juliana Pinho Müller Lara (Fonoaudióloga) **CRFa:** 8649 - PR

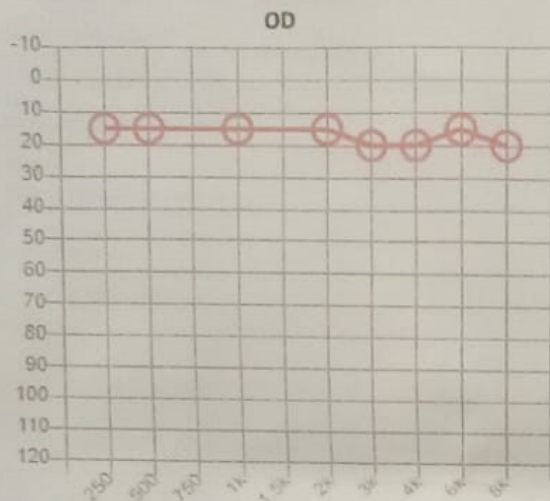

LIMIAIR OD								
	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k
VA	15	15	15	15	20	20	15	20
VO								

LIMIAIR OE								
	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k
VA	15	15	15	15	10	25	15	15
VO								

IRF		
	MONOS	DISSIL
OD		
OE		

RINNE				
	500	1k	2k	4k
OD				
OE				

WEBBER					
	250	500	1k	2k	4k
OD					
OE					

Audiômetro:	AMPLIVOX 260 (calibração: 24/02/2026)	R.A.:	
Diagnóstico:	OD: Normal OE: Normal	Meatoscopia:	OD: Normal OE: Normal
Observação:	Conduto auditivo (M).		
Conclusão:	Limiares auditivos dentro dos limites da normalidade bilateralmente. De acordo com o Anexo I da NR7.15		

☒ Normal ☐ Estável ☐ Alterado ☐ Agravamento

DATA: 13/04/2026

Fg* Juliana Pinho Müller Lara
CRFa: 8649 PR

*Juliana Pinho Müller Lara (Fonoaudióloga)
CRFa: 8649 - PR

Kelvin Manuel Romero Azocar
CPF: 713.068.372-43